

安徽留置针刺穿力设备厂家

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：35

吻缝合口压力试验仪YL00245-A是上海远梓电子科技有限公司生产研发，主要参数采用5.7英寸（120×90）单彩液晶触摸显示屏，中文菜单显示。并由键盘进行选择，吻合器的公称容量、泄漏试验所用的压力并在测试过程中显示所测压力，对测试所需时间，并可由机载打印机打印出测试结果。设备完全按照YY/T0245《吻（缝）合器通用技术条件》标准相关规定设计完成，试验材料为新鲜的猪肠（亦称肠腔）电源电压 $220V\pm 22V$ 电源频率 $50Hz\pm 0.5Hz$ 测试量程 $0\sim 6kPa$ 示值误差 $\pm 0.12kPa$ 远梓注射针测试仪采用触摸及按键双操作控制液晶显示屏上的菜单及液晶显示屏上的模拟键盘。安徽留置针刺穿力设备厂家

穿刺力


上海远梓厂家型号TR2024-A医用针灸针刚性测试仪采用5.7英寸（120×90）单彩液晶显示屏，中文菜单显示。公称规格、管壁、跨度、设定载荷、比较大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单，机载打印测试数据。管壁：正常壁、薄壁、超薄壁三种任选；公称规格 $0.2\sim 3.4mm$ ；设定荷载 $5.5\sim 60N$ 精度 $\pm 0.1N$ 加载速率：加载到设定值时其速度为 $1mm/min$ ；跨度 $5\sim 50mm$ ，精度 $\pm 0.1mm$ （11种规格）；挠度测试 $0\sim 0.8mm$ 精度 $\pm 0.1mm$ 打印方式：每次可打印8次、13次或20次测试数据及平均挠度值和偏差值。净重 $20kg$ 外形尺寸 $400\times 290\times 240mm$ 天津针管针刺穿力设备显示针灸针刺穿力，所有峰值力、峰值力距离数据及针体移动距离和力的记录图。符合YY0666-2008和GB2024



厂家型号TR2024-A医用针灸针刚性测试仪采用5.7英寸（120×90）单彩液晶显示屏，中文菜

单显示。公称规格、管壁、跨度、设定载荷、比较大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单，机载打印测试数据。管壁：正常壁、薄壁、超薄壁三种任选；公称规格 $\square 0.2 \square 3.4 \text{mm}$ ；设定荷载 $\square 5.5 \square 60 \text{N}$ 精度 $\square \pm 0.1 \text{N}$ 加载速率：加载到设定值时其速度为 1mm/min ；跨度 $\square 5 \square 50 \text{mm}$ ，精度 $\square \pm 0.1 \text{mm}$ （11种规格）；挠度测试 $\square 0 \square 0.8 \text{mm}$ 精度 $\square \pm 0.1 \text{mm}$ 打印方式：每次可打印8次、13次或20次测试数据及平均挠度值和偏差值。净重 $\square 20 \text{kg}$ 外形尺寸 $\square 400 \times 290 \times 240 \square \text{mm}$ 上海远梓电子科技有限公司成立于2006年，是一家集研发、制造、销售为一体的综合性医用检测仪器设备的高科技企业。公司产品普遍应用于医用产品的各类物理性能测试、检验、分析和研究；公司主要产品有医用注射针测试仪、注射器测试仪、输液针测试仪、输液器测试仪、缝合针测试仪、缝合线测试仪、手术刀片测试仪、留置针测试仪、**针测试仪、针灸针测试仪、节育器测试仪、牙科测试仪等医用产品等自行研发的130多种医用产品检测仪器、设备，可根据客户需求订制非标产品，欢迎您的来电。

上海远梓厂家生产医用缝合针测试仪TR0043-D医用缝合针弹性、韧性测试仪采用5.7英寸 $\square 120 \times 90 \square \text{PLC}$ 多彩液晶显示屏，中文菜单显示。公称规格、试验变形量、试验项目、打印、测试、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单，自动控制变形量，机载打印测试数据，弹性、韧性测试夹具更换方便，弹性测试自动完成。医用缝合针弹性、韧性测试仪完全符合YY0166-2002《带线缝合针》和YY0043-2016《医用缝合针》的标准设计制造。公称范围 $\square 0.2 \square 1.3 \text{mm}$ ； $12 \text{mm} \leq L \square 80 \text{mm}$ 位移范围 $\square 0 \square 25 \text{mm}$ 分辨率 $\square 0.01 \text{mm}$ 控制变形速率 $\square 0.01 \text{mm/s} \square 1 \text{mm/s}$ 打印方式：每次可打印10次测试结论。上海远梓国家高新技术企业针尖穿刺力测试仪用于注射针针灸针输液针针尖穿刺力值试验，质检化验室用穿刺力仪！

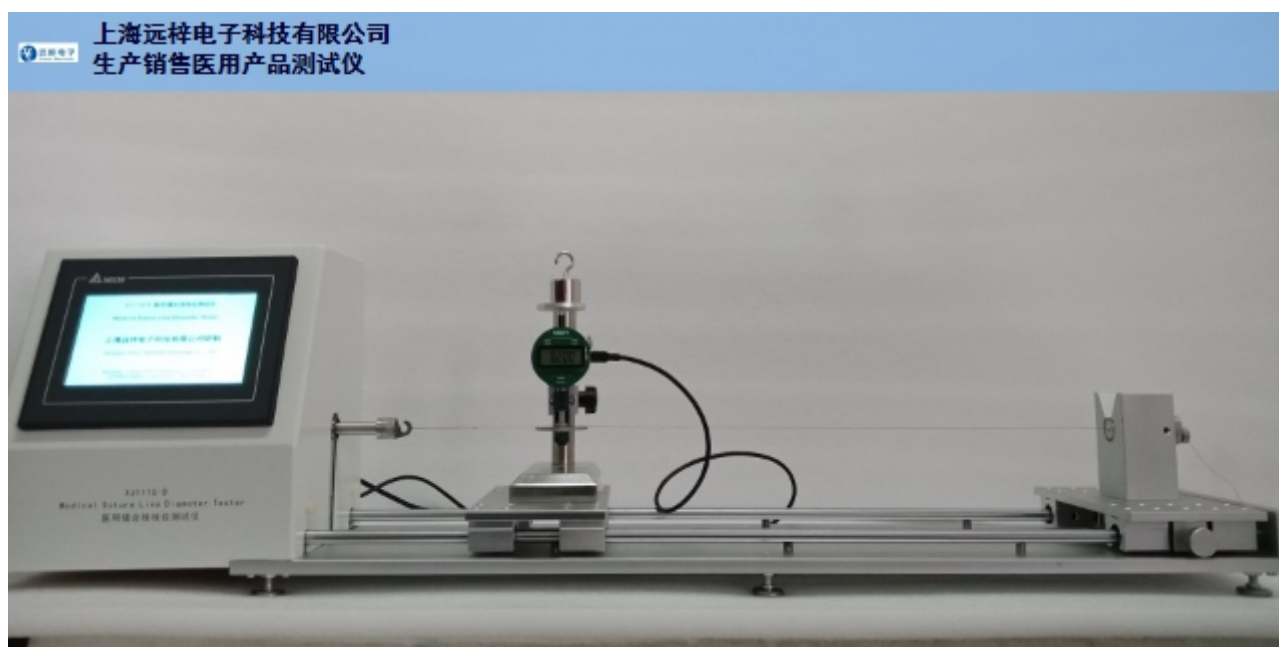

上海远梓厂家XJ1116-A医用缝合线线径测试仪采用5.7英寸（120×90）单彩液晶显示屏，中文菜单显示。公称规格、试验载荷、打印、测试、左行、右行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单，砝码加载张力，自动记录线径数据，自动输出数据报告，机载打印测试数据，完全符合“YY1116-2020”规定和YY0167-2020的相关规定公称规格：12-0……5所有I□II类医用缝合线线径测量分度 $\square 0.002 \text{mm}$ 压脚直径 $\square 12.7 \text{mm} \pm 0.02 \text{mm}$ 基准面直径 $\square 50 \text{mm}$ 压脚与基准面平整

度：不大于0.005mm压脚与基准面平行度：不大于千分之一加载砝码0~2kg精度0.1g压脚荷载210g±3g打印方式：可打印3点测量测试数据及平均值，可打印10次测试平均值数据及其总平均值和偏差值。净重38kg外形尺寸：320×1200×280上海远梓电子科技有限公司成立于2006年，是一家集研发、制造、销售为一体的综合性医用检测仪器设备的高科技企业。公司产品广泛应用于医用产品的各类物理性能测试，检验、分析和研究；公司主要产品有医用注射针测试仪、注射器测试仪、输液针测试仪、输液器测试仪、缝合针测试仪、缝合线测试仪、手术刀片测试仪、留置针测试仪、**针测试仪、针灸针测试仪、节育器测试仪、牙科测试仪等设备上海远梓YG2006-A医用留置针刚性测试仪采用采集导管屈服比较大强度，机载打印测试数据。安徽留置针刺穿力设备厂家

显示针灸针刺穿力，所有峰值力，峰值力距离数据及针体移动距离和力的记录图。符合YY0666-2008和GB2024安徽留置针刺穿力设备厂家

上海远梓电子厂家型号CL2024-A医用针灸针强度、刺穿力测试仪采用5.7英寸（120×90）单彩液晶显示屏，中文菜单显示。公称规格、测试次数、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单，机载打印测试数据。实时显示针灸针刺穿力、所有峰值力、峰值力距离数据及针体移动距离和力的记录图。完全符合YY0666-2008和GB2024相关规定。实验载荷0~12N精度0.1N分辨力0.01N移动速度100mm/min;（赠送）模拟皮肤：聚氨酯膜材料，符合GB158112001标准；打印方式：每次可打印8次、13次或20次测试数据及平均挠度值和偏差值。净重11kg外形尺寸400×290×240mm上海远梓电子科技有限公司（以下简称“远梓电子”）成立于2006年，是一家集研发、制造、销售为一体的综合性医用检测仪器设备的高科技企业。公司产品广泛应用于医用产品的各类物理性能测试、检验、分析和研究安徽留置针刺穿力设备厂家

上海远梓电子科技有限公司（以下简称“远梓电子”）成立于2006年，是一家集研发、制造、销售为一体的综合性医用检测仪器设备的高科技企业。公司产品广泛应用于医用产品的各类物理性能测试、检验、分析和研究；汽车产品的测试设备；汽车制动软管的组装及性能实验设备以及电子产品检验。企业设六部一室一中心：生产部、市场部、质保部、采购部、财务部、技术服务部、办公室、研发中心。在毗邻上海的昆山花桥镇设立了5000平米的生产基地和研发中心，并在全国各大城市设有销售服务中心。

公司主要产品有医用注射针测试仪、注射器测试仪、输液针测试仪、输液器测试仪、缝合针测试仪、缝合线测试仪、手术刀片测试仪、留置针测试仪、**针测试仪、针灸针测试仪、节育器测试仪、牙科测试仪等医用产品及车辆性能检测设备、汽车制动软管组装设备、汽车制软管检验设备等自行研发的130多种医用产品检测仪器、设备。

大多申请了国家**，产品广泛应用于医用产品制造、医院、国家医药管理、科研院所等单位的医用产品的各类力学物理性能测试、检验、分析和研究。

远梓电子秉承一贯的***要求、准确的交货期、原厂完整先进的技术经验与迅速完善的售后服务。